DYNAMIC DENTAL

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz

DAS CENTRAL X




DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz

DAS CENTRAL X

DAS Central X je pomocný systém pro intraorální skenování zcela bezzubých pacientů. Usnadňuje digitální zaznamenání polohy a orientace implantátů.

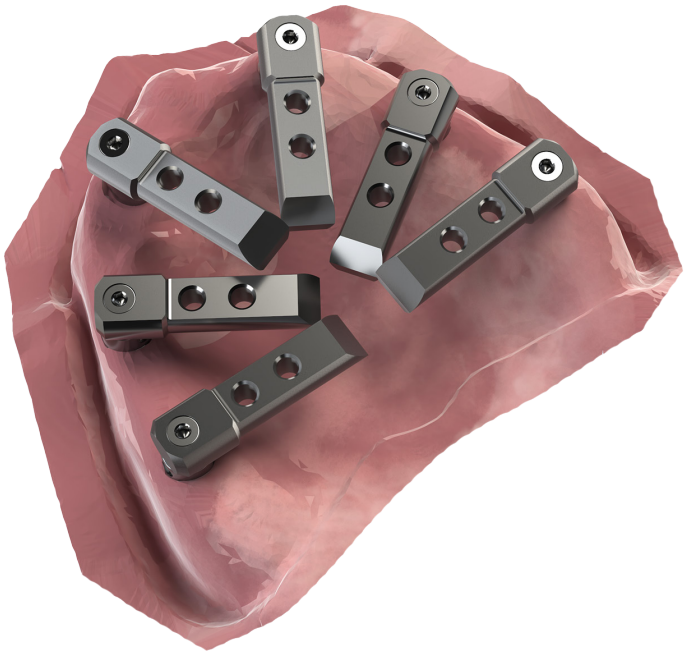

- Rychlé, přesné a jednoduché skenování.
- Jedinečná geometrie.
- Titan.
- Přímočařejší a intuitivnější pracovní postup.
- Kompatibilní se Scanbody Reference.
- Dostupný pro 56 kompatibilních systémů.

DYNAMIC DENTAL

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz


JEDNODUCHÝ POSTUP SKENOVÁNÍ

Zvyšuje počet referenčních bodů a přibližuje je k sobě. Natočením hlaviček směrem do středu čelisti se skenovaná oblast zúží, což usnadňuje intraorálnímu skeneru orientaci a omezuje riziko chyb.




KROK 1

Sken dásně.

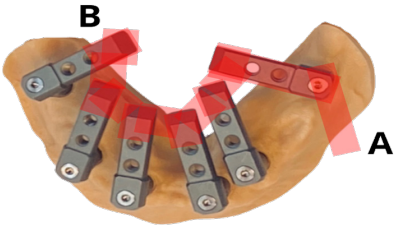

KROK 2

Skenování se systémem Central X.

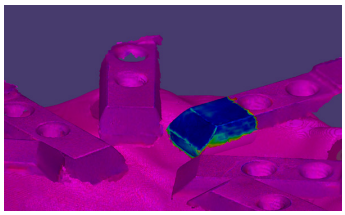

KROK 3

Optimální zarovnání přímo v CAD softwaru.

NÁVRH V CAD

Knihovny DAS

3shape

exocad

POZNÁMKA:

Central X má jednotnou geometrii a je kompatibilní se všemi Scanbody Reference.


DYNAMIC DENTAL

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz


JAK FUNGUJE SYSTÉM CAPS

Central X a systém CAPS přinášejí nové možnosti
v digitální implantologické protetice.

PRO ZÁZNAM **VERTIKÁLNÍHO ROZMĚRU**

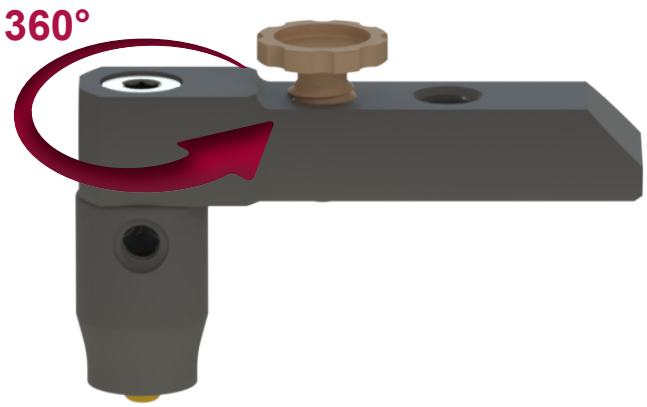

CENTRAL X UMOŽŇUJE OPTIMÁLNÍ
NASTAVENÍ SE SYSTÉMEM CAPS

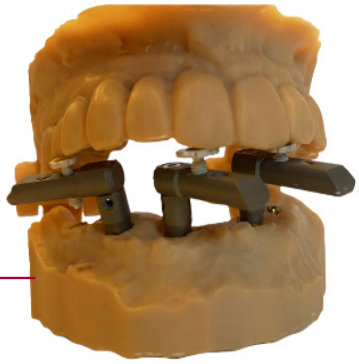

✔ NEOMEZENÁ MOŽNOST
ROTACE 360°



Central X se
nasazuje na
Scanbody
Reference

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz

JAK FUNGUJE SYSTÉM CAPS


CENTRAL X, SYSTÉM CAPS A SCANBODY REFERENCE



DAS CENTRAL X




SCANBODY REFERENCE



CAPS



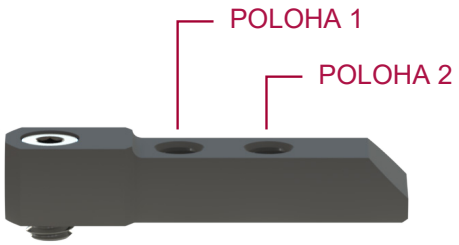



+ Fixační šroub Central X.

Používá se se systémem DAS MU / Multi-Unit.

DYNAMIC DENTAL


Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz

PRACOVNÍ POSTUP SE SYSTÉMEM CAPS

POUZE PŘI ZÁZNAMU VERTIKÁLNÍHO ROZMĚRU

KROK 1

Povolte,
ale nevyjímejte.

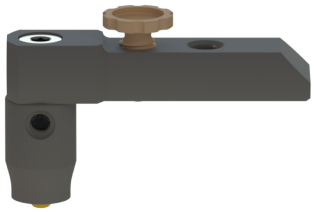




KROK 2

Přizpůsobte
oblouku.

KROK 3

Nasaďte
CAPS.




KROK 4

Znovu utáhněte.

KROK 5

Naskenujte.



POZNÁMKY:

Obvykle stačí 1 až 2 kusy CAPS na každé straně.
Při nedostatku vertikálního prostoru nepoužívejte sílu.

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz

KOMPONENTY DAS CENTRAL X



DAS Central X

53.322.997.01-2



Scanbody Reference

54.322.008.31-2
54.322.020.31-2
54.322.025.31-2
54.322.074.31-2
54.322.101.31-2
54.322.146.31-2
54.322.158.31-2
54.322.181.31-2
54.322.183.31-2
54.322.193.31-2
54.322.195.31-2
54.322.242.31-2
54.322.247.31-2
54.322.205.31-2

CAPS



Standardní (Regular)

49.418.000.01-2 (3,8 mm)
49.419.000.01-2 (6 mm)
49.420.000.01-2 (8 mm)



Široké (Wide)

49.418.000.02-2 (3,8 mm)
49.419.000.02-2 (6 mm)
49.420.000.02-2 (8 mm)



Šestihranný šroubovák 1,20

43.601.103.02-2

* Referenční šroubovák podle kompatibilního systému.

DAS MU Scanbody Reference

54.322.209.31-2



Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno, DIČ CZ04252756
e-mail: info@dynamicdental.cz
e-shop: www.dynamicdental.cz

PŘEHLED KOMPATIBILIT

Scanbody Reference jsou u DAS dostupné pro následující kompatibility:

Vlastní systém DAS Multi-Unit - dostupných je **262 platforem pro DAS Multi Unit pilíře**. Podrobný přehled odpovídá **kompatibilitám u DAS Fotogrammetrie**.

AB, ACE, ADIN, ALFA-GATE, ALPHABIO, ANCLADEN, ANKYLOS, ANTHOGYR, ARDS, ASTRA, AVINENT, B&W, BEGO, BIOCONCEPT, BIOGENESIS, BIOHORIZONS, BIOMET 3i, BIONER, BIOTEC, BIOTEM, BREDENT MEDICAL, BTI, BTK, CAMLOG, CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE, CORTEX, COWELLMEDI, DENTAL TECH, DENTIS, DENTIUM, DIO IMPLANTS, DITRON, DMI DENTAL SUPPLY, DSP BIOMEDICAL, EASY IMPLANT, ECKERMANN, ELITE MEDICA, EUROTEKNIKA, F&B IMPLANT (FIT & BRILLIANT), GALIMPLANT, GMI (ILERIMPLANT), GT MEDICAL, HAHN IMPLANT (GLIDEWELL), HI-TEC, HIOSSEN, IBS, IDO IMPLANTS, IHDE DENTAL (IMBIODENT), IMPLANT DIRECT, IMPLANT GENESIS, IMPLANTSWISS, INTRA-LOCK, JDENTALCARE, KEYSTONE, KLOCKNER, LEADER, MEDENTIS, MEGAGEN, MICRODENT, MIS, MOZO-GRAU (TICARE), MPI, NEOBIOTECH, NEODENT, NOBEL BIOCARE, NORIS MEDICAL, OSSTEM IMPLANT, OSTEOPLUS, OXY, PALTOP, PHIBO, PROCLINIC, RADHEX, REFLECT, SEWON MEDIX, SIC INVENT, SIGNO VINCES, SIN IMPLANTS, SOUTHERN IMPLANTS, STERNGOLD, STRAUMANN, SURCAM DENTAL, SYSTHEX, TITANIUM-FIX, TREE-OSS, TRI DENTAL IMPLANTS, TRINON, VULKAN IMPLANTS, WARANTEC (ONEPLANT), XIVE, YES IMPLANT, YOUSE IMPLANTS, ZIACOM, ZIMMER

Kompatibilita s originálními MU pilíři - 56 dalších variant

Scanbody Reference	Značky implantátů / originální MU pilíře	Strany katalogu
54.322.008.31-2	ASTRA	62-63
54.322.020.31-2	MIS	91-92
54.322.025.31-2	AB, ACE, ADIN, AVINENT, BIOHORIZONS, BIOMET 3i, BIONER, CORTEX, DENTIS, EASY IMPLANT, EUROTEKNIKA, GALIMPLANT, GMI (ILERIMPLANT), HAHN IMPLANT (GLIDEWELL), IMPLANTSWISS, JDENTALCARE, MEDENTIS, MEDENTIKA, MEGAGEN, MONOIMPLANT, NEOBIOTECH, NEODENT, NOBEL BIOCARE, OSSTEM IMPLANT, SEWON MEDIX, SIN IMPLANTS, SOUTHERN IMPLANTS, TREE-OSS, WIN; navíc ASTRA v oddílu kompatibility 0258	103-104, 318-319
54.322.074.31-2	ANTHOGYR, DENTIUM, DENTIS, DIO IMPLANTS, EUROTEKNIKA, GT MEDICAL, IMPLANT DIRECT, MEGAGEN, PROCLINIC, STRAUMANN, TRINON, ZIMMER	172-173
54.322.101.31-2	STRAUMANN	203-204
54.322.146.31-2	BREDENT MEDICAL	-
54.322.158.31-2	IMPLANT DIRECT	245
54.322.181.31-2	PALTOP, SURCAM DENTAL	270-271
54.322.183.31-2	ANKYLOS	272-273
54.322.193.31-2	COWELLMEDI, DENTIUM	283-284
54.322.195.31-2	ALPHABIO	285-286
54.322.242.31-2	OXY	305-306
54.322.247.31-2	DIO IMPLANTS	310-311
54.322.205.31-2	ZIMMER	290-291

Čísla stran odkazují na katalog uvedený ve zdrojovém přehledu kompatibilit.